ITS Lite

ПО BAUR для управления данными измерений

Характеристики

- Автоматическое считывание протоколов измерений измерителей электрической прочности жидкостей BAUR:
  - DPA 75 C
  - DTA 100 C
  - DTL C
- Архивирование протоколов измерений на ПК в формате PDF или в виде текстовых файлов (*.txt)
- Пользовательский интерфейс, протоколы измерений и пользовательская документация на 11 языках
- Автоматическая печать протоколов измерений на ПК
- Простое, удобное управление на базе Microsoft Windows™

Эффективное управление данными измерений при проверке изоляционных материалов

- Автоматическое архивирование протоколов измерений в формате PDF и в виде текстовых файлов (*.txt)
- Структурированное хранение и привязка протоколов измерений
- Настраиваемая структура протоколов измерений
- Быстрый и простой доступ к данным измерений

Программное обеспечение BAUR ITS Lite предназначено для автоматического считывания результатов измерения, оформления и архивирования протоколов измерений измерителей электрической прочности жидкостей DPA 75 C, DTA 100 C и DTL C. При этом протоколы можно сохранять в формате PDF или в виде текстовых файлов (*.txt). Обширная языковая поддержка и вставка индивидуальных логотипов обеспечивают профессиональное создание отчетов.

Таким образом ПО BAUR ITS Lite поддерживает пользователя во всём процессе проверки масла, надежно и структурированно регистрируя данные измерений без больших затрат. Процесс трудоемкого создания информативных протоколов измерений теперь в прошлом, можно значительно сократить расходы на проверку масла.

Предлагается для бесплатной загрузки на сайте www.baur.eu

BAUR GmbH · Raiffeisenstraße 8, 6832 Sulz, Австрия · Тел.: +43 (0)5522 4941-0 · Факс: +43 (0)5522 4941-3 · headoffice@baur.eu · www.baur.eu

Технические данные

Общие данные		
Поддерживаемые измерители электрической прочности жидкостей BAUR	DPA 75 C DTA 100 C DTL C	
Формат экспорта данных	Формат PDF Текстовый файл (*.txt)	
ПО предлагается	немецкий, английский, французский, итальянский, корейский, голландский,	польский, португальский, русский, испанский, чешский

Системные требования	
Процессор	мин. 1 ГГц
Оперативная память	мин. 512 Мб
Свободное место на жестком диске	мин. 100 Мб
Поддерживаемые операционные системы	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11
.Net Framework	4.0
Интерфейс для передачи данных	USB 2.0
Версия прошивки измерителей электрической прочности жидкостей BAUR	DPA 75 C: 1.07 или выше DTA 100 C: 1.07 или выше DTL C: 1.12 или выше

Пример подключения нескольких измерителей электрической прочности жидкостей BAUR

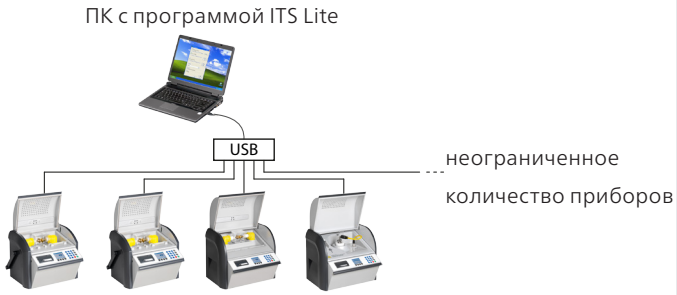

Объем поставки

- ПО BAUR ITS Lite
- Руководство по эксплуатации

Пример протокола измерений

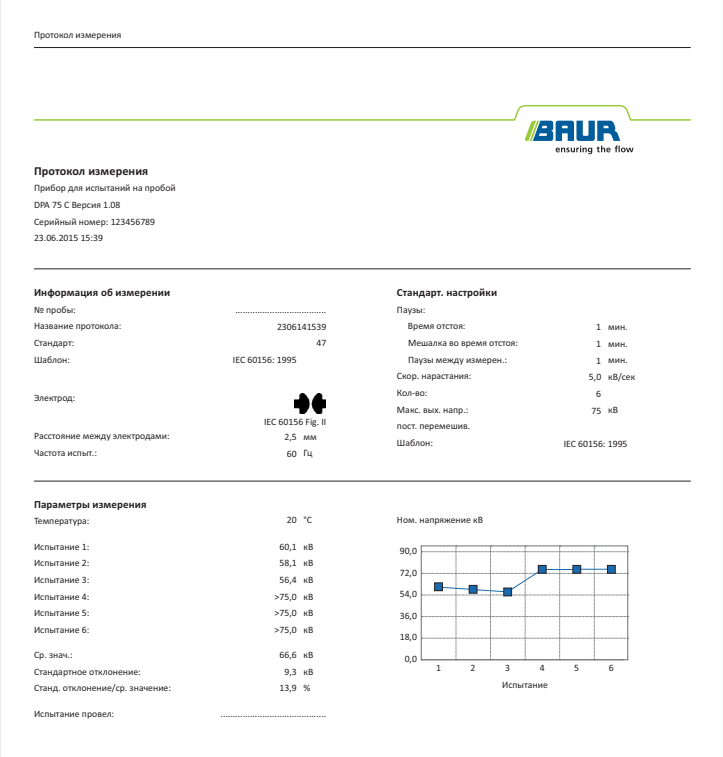

Протокол измерения

BAUR ensuring the flow

Протокол измерения
Прибор для испытаний на пробой
DPA 75 C Версия 1.08
Серийный номер: 123456789
23.06.2015 15:39

Информация об измерении

№ пробы:	.....
Название протокола:	2306141539
Стандарт:	47
Шаблон:	IEC 60156: 1995
Электрод:	IEC 60156 Fig. II
Расстояние между электродами:	2,5 мм
Частота испыт.:	60 Гц

Стандарт. настройки

Паузы:	
Время отстоя:	1 мин.
Мешалка во время отстоя:	1 мин.
Паузы между измерен.:	1 мин.
Скор. нарастания:	5,0 кВ/сек
Кол-во:	6
Макс. вых. напр.:	75 кВ
пост. перемешив.	
Шаблон:	IEC 60156: 1995

Параметры измерения

Температура:	20 °C
Испытание 1:	60,1 кВ
Испытание 2:	58,1 кВ
Испытание 3:	56,4 кВ
Испытание 4:	>75,0 кВ
Испытание 5:	>75,0 кВ
Испытание 6:	>75,0 кВ
Ср. знач.:	66,6 кВ
Стандартное отклонение:	9,3 кВ
Станд. отклонение/ср. значение:	13,9 %
Испытание провел:	.....

Ном. напряжение кВ

Вы хотите получить больше информации об этом продукте?
Свяжитесь с нами: www.baur.eu > BAUR worldwide

Технический паспорт: BAUR GmbH · 896-179-8 · 07.2025 · Публикуется с правом внесения изменений